～ 全ては「生きがい」創造のために ～

吉村メディカル福祉株式会社

（第２種医療機器製造販売事業所）

温灸器

品番

YMW-ONQ001

医療機器認証番号

226AKBZX00166000号

取扱説明書

携帯型温灸器　ながら灸

このたびは、製品をお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。

●取扱説明書をよくお読みになって、安全にお使いください。
●ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
●保証書は取扱説明書とともに大切に保管して下さい。

nagara

目次

【 安全上のご注意　～必ずお守りください～ 】 3
【 各部の名前 】 6
【 付属品 】 7
【 機能一覧表 】 8
【 使用目的、効能又は効果 】 9
【 操作方法又は使用方法 】 10
【 カーボンヒーターの発熱方法 】 11
【 強さモードの切替 】 12
【 その他の表示説明 】 13
【 装着方法 】 14
【 専用粘着ゲルパッド（別売）の装着方法 】 15
【 充電方法 】 16
【 こんな異常を感じたら 】 17
【 定格・仕様 】 18
【 保証とアフターサービス 】 19

安全上のご注意 ～必ずお守りください

●人への危害、財産の損害を防止する為、必ずお守りいただくことを説明しています。
●誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠	**警告**「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です
⚠	**注意**「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

してはいけない内容です。	実行しなければならない内容です。

⚠ 警告

禁止

●次のような医療電気機器との併用は、誤作動を招く恐れがありますので、使用しないでください。
（1）ペースメーカー、植込み型除細動器などの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器
（2）心電計などの装着型の各医用電気機器

●睡眠薬等を服用した人及び酩酊（酔っている）状態の人は使用しない。
●心臓の近く、頭部、顔、口中や陰部、皮膚疾患などには使用しない。
●他の治療器との同時使用や塗り薬（スプレー式など含む）との併用はしない。
●こたつや布団の中では使用しない。
●就寝時には使用しない。
事故やけがのおそれがあります。また、本体が別の場所（心臓近く、頭部、顔、口中や陰部、皮膚疾患など）に移動して事故や体調不良を起こすおそれがあります。

●治療以外の目的には使用しない。
●お子様や自分で意思表示ができない人に使わせない。
また、自分で操作できない人への使用はさせない。
事故やけがのおそれがあります。

⚠ 警告

禁止

●本体を水につけたり、水をかけたりしない。
使用したまま、シャワーを浴びたり入浴などしない。
●浴室など湿度の高いところでは使用しない。
事故やけが、故障の原因になります。

●本体をひもやベルトで固定しない。
外しにくいと事故や火傷のおそれがあります。

割れたり欠けたりして、事故やけが、故障の原因になります。
●ホタル石灸点部に汚れをつけたまま使用しない。
汚れると熱がつたわりにくくなります。

●絶対に改造しない。また、ご自分で分解したり改造、修理をしない。
発火や事故・けがの原因になります。ホタル石灸点部の欠けや破損、断線、ヒーターの故障、本体が異常に熱くなるなど異変を感じた場合、ただちに使用を中止し、お買い上げの販売店にご相談ください。

必ず守る

●医師の治療を受けている時や下記の人は必ず医師と相談のうえ使用する。
(1)悪性腫瘍のある人　(2)心臓に障害 のある人　(3)温度感覚喪失が認められる人　(4)安静を必要とする人　(5)糖尿病などによる高度な末しょう（梢）循環障害による知覚障害がある人　(6) 妊娠初期の不安定期又は出産直後の人(7)適用部位の皮膚に異常(感染症、創傷など）のある人　(8)体温38℃以上（有熱期）の人　－急性炎症症状【倦怠感、悪寒、血圧変動など】の強い時期、衰弱している時　(9) 脊椎(せきつい)の骨折、捻挫、肉離れなど、急性［ とう(疼)痛症］疾患の人　(10) 低温やけどをしたことのある人　(11)上記以外に特に身体に異常を感じている人
守らないと事故や体調不良を起こすことがあります。

●やけどしそうな激しい熱刺激、痛みを感じたらすぐに離す。
●１時間を超えて使用する場合、次の人は、医師と相談する。
高血圧の人、不整脈のある人、睡眠時無呼吸症の人、喘息の人
守らないと事故ややけど、体調不良を起こすことがあります。

⚠ 注意

禁止

●自動車などの運転の直前および運転時には使用しない。
事故やトラブルのおそれがあります。
●本体は幼児の手の届くところに置いたり保管したりしない。
万一本体を飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。
●本体を火中に投入しない。
リチウムポリマー電池が内蔵されており火中で爆発の恐れがあります。

必ず守る

●ホタル石灸点部は正しく装着する。
● 肌に固定する場合は、必ず別売の専用粘着ゲルパッドを使用する。
●１日１か所に１５分以内で使用する。
長時間同じところに使用すると、皮膚にやけどが生じます。
●使用中に身体に異常や肌に発疹、発赤、かゆみなどの症状があらわれた場合は、使用を中止し、医師に相談する。
●しばらく使用しても、効果が現れない場合は、使用を中止し医師または専門医に相談する。
●本体が破損、または正常に動作しないときは使用を中止し電源を切る。
守らないと事故や体調不良の恐れがあります。

●一人用機器であり、複数の人が同時に使用しない。
●使用前に操作スイッチが正常に作動するか確認する。
●しばらく使用しなかった場合は機器が正常かつ安全に作動することを確認してから使用する。
守らないと事故や故障、体調不良の恐れがあります。
●停電のときは直ちに電源を切る。
●治療する際は充電部カバーを閉じて使用する。
守らないと事故や故障の原因になります。

●治療が終了後は電源を切り、ホタル石灸点部や皮膚に接触する部分の汚れをふき取り本体を閉じた状態で湿気の少ないところに整理保管する。
守らないと事故や故障の原因になります。
●全てのコードは容易に離脱しないよう、正しく確実に接続する。
●コネクタを取付け・取り外しするときは接続部に無理な力をかけない。
守らないと本体破損や故障の原因になります。

●機器及び附属品の廃棄に関しては地域で定める条例に従ってください。

【 各部のなまえ 】

【本体】

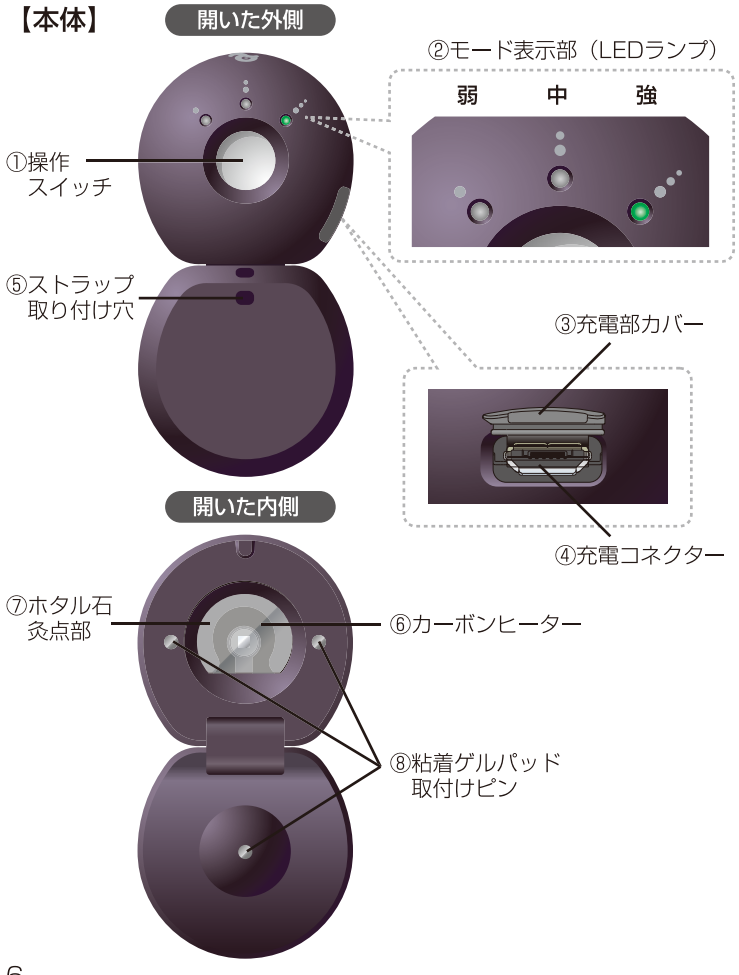

【 付属品 】

⑨ACアダプター
（品番YMW-ONQ001A01）



⑩マイクロUSBケーブル
（品番YMW-ONQ001B01）



⑪収納ケース



⑫取扱説明書

【別売品】

⑬粘着ゲルパッド
（品番YMW-ONQ001C01）



【 機能一覧表 】

名称	内容
①操作スイッチ	本体電源のON,OFF,強さの切り替え、治療を開始する際に押す。
②モード表示部（LEDランプ）	LEDランプ上部のドットの数で強さを表す。ドット一つは弱、ドット二つは中、ドット三つは強を表す。LEDは、緑、青、黄色で構成されており色と点灯、点滅の組み合わせで意味を表す。（別紙に説明あり）
③充電部カバー	治療中は閉じ、充電部には開いて使う充電コネクター部のふた。
④充電コネクター	本体を充電する際にマイクロUSB端子を差し込む部位。
⑤ストラップ取付穴	ストラップや紐を通す部位。
⑥カーボンヒーター	電流を流すと、カーボン自身の抵抗により発熱し熱を伝える。
⑦ホタル石灸点部	カーボンヒーターの熱を通す導子。
⑧粘着ゲルパッド取付ピン	別売り粘着ゲルパッドを使用する際に取付ける部位。
⑨ ACアダプター	本体を充電する際に、本体をマイクロUSBケーブルとつなぎ、家庭用電源に差し込んで使用する専用電源。出力電圧ＤＣ５Ｖ.出力電流1.2Ａ
⑩マイクロUSBケーブル	本体を充電する際に使用するACアダプタと本体をつなぐコード。
⑪収納ケース	本体を収納する入れ物。
⑫取扱説明書	本体の名称、使用方法、警告、注意等を記した書類。
⑬粘着ゲルパッド(別売品)	本体をハンズフリーで使用する場合に使用する。粘着ゲルを介して肌に直接貼り付け、本体を身体に固定する。

【 使用目的、効能又は効果 】

局所への加熱による灸の代用。
一般家庭で使用するもの

●温熱治療
カーボンヒーターによる温熱効果

●疲労回復。
●血行をよくする。
●筋肉の疲れをとる。
●筋肉のこりをほぐす。
●神経痛、筋肉痛の痛みの緩解。
●胃腸の働きを活発にする。

【 操作方法又は使用方法等 】

・電池は未使用時も自己放電します。お買い上げの電池は必ず充電してからお使いください。
・また長時間ご使用にならなかった電池を再びご使用になる際も、必ず再充電してください。

1 本体を開きます。
本体を閉じたままでは操作できません。

2 操作スイッチを押し、電源を入れます。
ピピッと音が鳴り、どれか一つの緑LEDランプが点滅し待機モードになります

3 操作スイッチをもう一度押します。
ピッと音が鳴り、緑LEDランプが点灯に変わります。

4 本体を身体の希望の個所に取付け治療を開始してください。
カーボンヒーターで加熱している時はLEDランプが黄色に点灯します。

5 約１５分経過するとタイマーで自動的に電源が切れて治療を終了します。
途中で終了したい場合は操作スイッチを押すか本体を閉じます。

【 カーボンヒーターの発熱方法 】

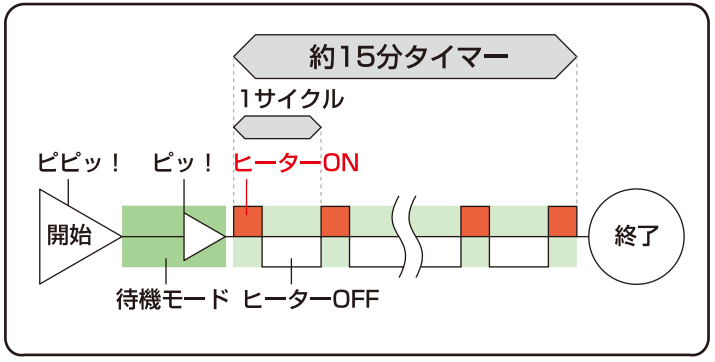

- 操作スイッチを押して治療を開始します。
- カーボンヒーターがONになると発熱し、ホタル石灸点部を通して肌に熱が伝わります。
- 強さモードごとに決められた時間を経過するとカーボンヒーターがOFFになり発熱を休止します。
- 肌への熱の影響を緩和するため強さモードごとに決められた時間までOFFの状態を継続します。
- このサイクルの発熱時間と休止時間の長さを変えることで強度モードの『弱』、『中』、『強』を調整しています。（１サイクルの長さは約６０～１００秒です。）
- このサイクルを設定されたタイマー時間の約１５分間繰り返し自動的に電源が切れて終了します。
- 肌への熱の影響をより低減するため、『弱』・『中』モードには内蔵の肌温度センサの値でカーボンヒーターをＯＦＦにする安全機能がついています。

【 強さモードの切替 】

1 待機モードから操作スイッチを長押し（２秒程度）すると、ピピッと音がして緑LEDランプが早く点滅し強さ選択モードに入ります。このモード中は現在の強さ状態の緑LEDランプの点滅と音
【ピッ（弱）、ピピッ（中）、ピピピッ（強）】を繰り返します。
（購入時は弱に設定されています。２回目以降は前回終了時の選択モードからスタートします）

2 操作スイッチを押す毎に次に選択される強さの状態音【ピピッ（弱→中）、ピピピッ（中→強）、ピッ（強→弱）】がして緑LEDランプの点滅位置が切り替わります。

（注意）
LEDが点滅中は１０秒以上操作されないと自動的に電源が切れます。

3 強さを選択したら、ピーと音がするまでスイッチを長く押すと決定します。緑LEDランプが早い点滅からゆっくりした点滅に切り替わり待機モードになります。

強さ	弱	中	強
ブザー音	ピッ	ピピッ	ピピピッ

【 その他の表示説明 】

表示＼状態	電池切れ	充電中	異常発生時
ブザー音	ピー×５回	----	ピー×５回
ＬＥＤランプ	３ヶ所全てのランプが緑に点滅	中央のランプが青に点灯	３ヶ所全てのランプが黄色に点滅
対応	充電してください	----	使用を中止してください

【 装着方法 】

●気持ち良い、心地よいと感じる場所に本体をあてて下さい。

●肌に固定された状態で治療する場合は、必ず別売りの専用粘着ゲルパッド（品番YMW-ONQ001C01）をお使いください。

●ストラップを付ける場合は一般用ストラップをお使いください。

時間：１ヶ所　１５分以内
タイマーで１５分経つと自動的に切れます。

回数：１ヶ所　１日１回

強さ：気持ちいいと感じる程度。
痛みを感じたらすぐに外して下さい。

【 専用粘着ゲルパッド（別売）のセットの仕方 】







※必ず電源を切り、モード選択部のLEDランプがすべて消灯した状態で行って下さい

1 専用粘着ゲルパッドA，Bを袋から取り出す。

2 専用粘着ゲルパッド（A，B）を本体のゲルパッドピンに取り付ける。



3 専用粘着ゲルパッドに付いている透明フィルムをはがす

専用粘着パッド取り扱いのお願い
●使用後はよく汚れを拭き取り本体に収納してください。
●粘着力が弱くなってきたら、水で湿らせた布（毛羽立ちにくい布）等で汚れを拭き、粘着面を自然乾燥させてご使用ください。
●手入れしても粘着力が回復しない場合は新しいものに取り換えてください。
●専用粘着ゲルパッドで固定している肌の部分に異常を感じたり肌に合わない場合は使用を中止し、医師に相談してください。

【 充電方法 】

充電は、必ず付属の専用ＡＣアダプターと専用マイクロＵＳＢケーブルを使用し、燃えやすいものがない平らで安全な場所で行ってください。

1 本体の充電部カバーを開けます。

2 専用ＡＣアダプタのＵＳＢコネクタに付属の専用マイクロUSBケーブルのＵＳＢコネクタを差し込みます。



3 本体の充電コネクターに付属の専用マイクロUSBケーブルのマイクロＵＳＢコネクタを差し込みます。

4 専用ACアダプターのプラグを家庭用電源のコンセントに差し込むと充電を開始します。充電中は中央の青ＬＥＤが点灯し、充電が完了すると消灯します。（フル充電時間:約３時間３０分）



5 充電が完了したら専用ＡＣアダプターと専用マイクロＵＳＢコネクターを本体から取り外し、本体の充電部カバーを閉じます。

●フル充電で５～６回使用できます。
●充電池は充電を繰り返すことにより性能が徐々に劣化します。規定の時間充電をしても使用時間が短いと感じられる時は電池の寿命が原因と考えられますので、製造販売元で新しい電池と交換してください。

【 こんな異常を感じたら 】

症状	原因と処置		
・ＬＥＤランプが点灯しない	電池が消耗していませんか？	電池を充電してください。	→ 点検後なお異常がある
	本体を開いて操作スイッチを押していますか？	本体を閉じたまま操作している場合は本体を開いてください。	→ 点検後なお異常がある
・熱が全く感じられない ・熱が弱い	ホタル石灸点部と肌の間に布等が入っていませんか？ ホタル石灸点部と肌の距離が離れすぎていませんか？ ホタル石灸点部が汚れていませんか？		→ 点検後なお異常がある
・使用中、15分間使用していないのに切れる。	電池が消耗していませんか？	電池を充電してください	→ 点検後なお異常がある
・強度を強にしても熱が弱いまたは、感じない	冬場など、肌が冷えている場合は温度が上がりにくいので、時間がかかる場合があります。		→ 点検後なお異常がある
・全ＬＥＤランプが緑色に点滅する	電池が無くなったサインです	電池を充電してください	→ 点検後なお異常がある
・全ＬＥＤランプが黄色に点滅する	機器に異常が発生しています。システム異常、ヒーター断線の可能性があります。直ちに製造販売元に連絡してください。		→ 点検後なお異常がある

・直ちに使用を中止し事故防止の為必ず製造販売元にご相談ください。

【 定格・仕様 】

販売名	温灸器　ＹＭＷ-ＯＮＱ００１
本体寸法	使用時　縦74 × 横38 × 高さ13 mm 保管時　縦37 × 横38 × 高さ25 mm
質量	23g
使用電池	リチウムポリマー充電治（330ｍＡｈｒ）
定格電流	0.1A
定格電圧	5V
定格入力	0.5W
タイマー	約15分
種別	機械器具80 はり又はきゅう用器具
一般的名称	温灸器
医療機器の種類	管理医療機器
医療機器認証番号	226AKBZX00166000 号
製造販売元	吉村メディカル福祉株式会社 大阪府枚方市楠葉野田2丁目30-10 電話：072-807-3523
製造元	サンセイ株式会社

【 保証とアフターサービス 】

よくお読みください

【こんな異常を感じたら】でご確認のあと、
直らないときは、ご使用を中止し、
以下の内容をご連絡ください。

●製品名　温灸器
●品　番　ＹＭＷ-ＯＮＱ００１
●故障の状況を詳しく具体的に

●保証期間：お買い上げ日から本体１年間

※保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、
ご要望により有償で修理させていただきます。

●修理、使い方、お手入れ方法に関するご相談は

吉村メディカル福祉株式会社

〒573-1103 大阪府枚方市楠葉野田2丁目30-10
TEL：072-807-3523　FAX：072-855-5438

MEMO